


Esperoct® KURZANLEITUNG



esperoct®
turoctocog alfa pegol

Esperoct®: ÜBERBLICK ZUM PACKUNGSINHALT

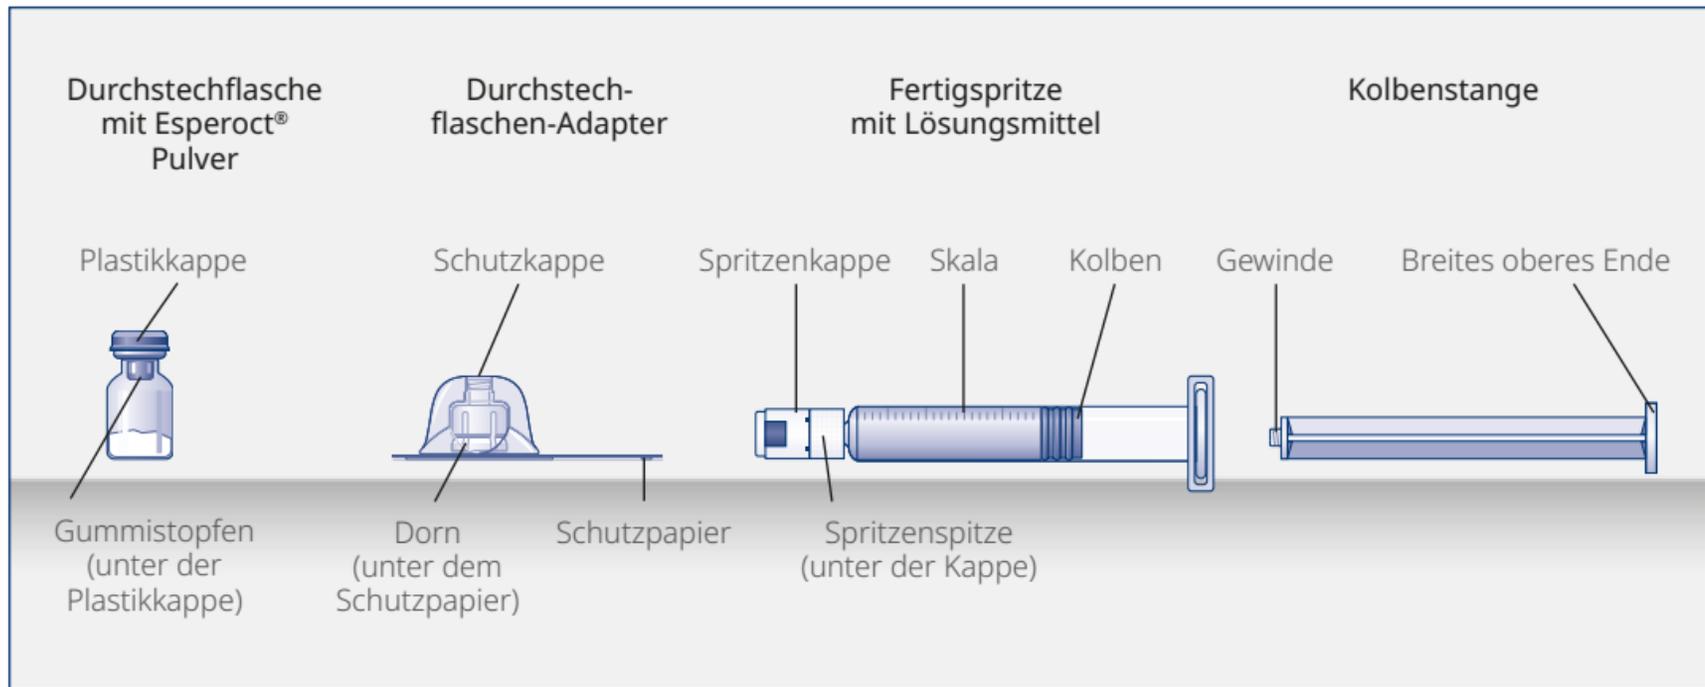

Esperoct®: VORBEREITUNG DER INJEKTION



Vorbereitung der Medikation



Anbringen des Adapters an der Flasche




Verbinden der Fertigspritze mit der Kolbenstange



Mischen von Pulver und Lösungsmittel

VORBEREITUNG DER MEDIKATION

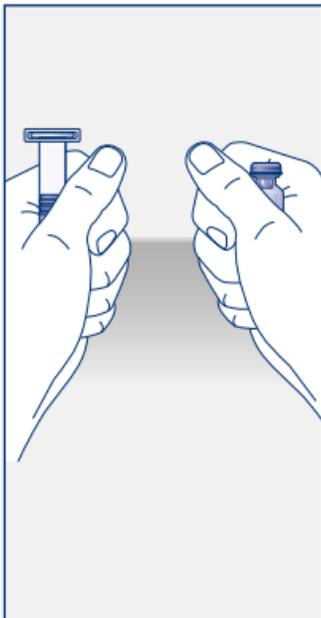

Prüfen Sie Verfallsdatum, Name, Dosis und Farbe jeder Esperoct® Packung.

❗ Waschen und trocknen Sie sorgfältig die Hände, bevor Sie die Umverpackung öffnen.

Nehmen Sie die Durchstechflasche, den Durchstechflaschen-Adapter und die Fertigspritze aus dem Karton. Lassen Sie die Kolbenstange unberührt im Karton.

Sind die Durchstechflasche und die vorgefüllte Spritze kalt, erwärmen Sie diese mit Ihren Händen (nicht über 37 °C).*



Entfernen Sie die Plastikkappe von der Durchstechflasche.


Verwenden Sie diese nicht, wenn die Plastikkappe locker ist oder fehlt.

Reinigen Sie den Gummistopfen mit einem sterilen Alkoholtupfer und lassen Sie ihn trocknen.

❗ Berühren Sie den Gummistopfen nicht mit Ihren Fingern, damit er steril bleibt.


*Verwenden Sie keine andere Methode zum Erwärmen!

ANBRINGEN DES ADAPTERS AN DER FLASCHE

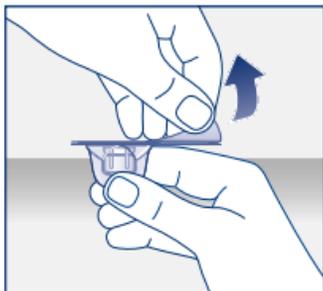


Entfernen Sie das Schutzpapier, um die Schutzkappe des Adapters zu öffnen. Verwenden Sie diesen nicht, wenn das Schutzpapier nicht vollständig versiegelt oder es beschädigt ist.

i Berühren Sie den Adapter nicht, damit er steril bleibt.

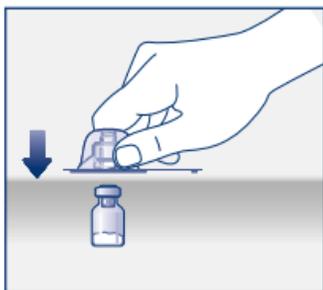

Stellen Sie die Durchstechflasche auf eine flache und feste Oberfläche. Drehen Sie die Schutzkappe um und lassen Sie den Adapter an der Durchstechflasche einrasten.

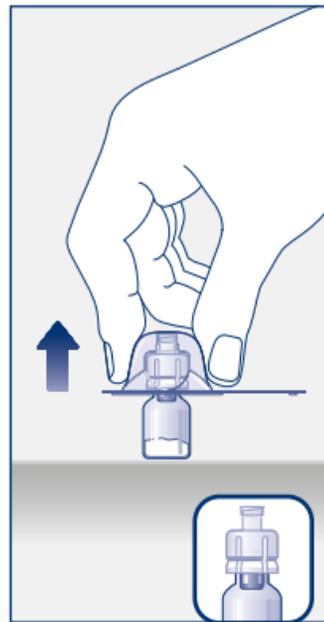


i Ist der Adapter einmal an der Flasche befestigt, dürfen Sie ihn nicht mehr entfernen.

Drücken Sie die Kappe vorsichtig zusammen, um sie zu entfernen.

i Heben Sie beim Entfernen nicht den Adapter von der Durchstechflasche ab.


VERBINDEN DER FERTIGSPRITZE MIT DER KOLBENSTANGE

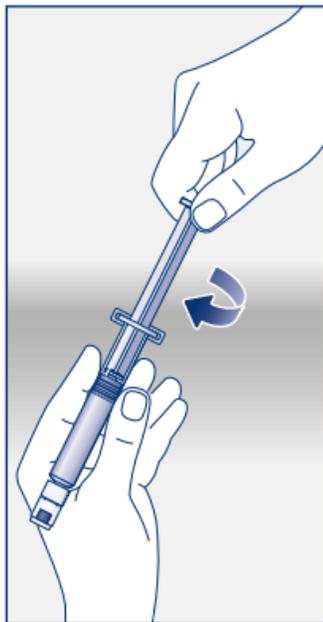

Fassen Sie die Kolbenstange am breiten oberen Ende an und nehmen Sie sie aus dem Karton.


Schrauben Sie die Kolbenstange sofort in die Spritze. Drehen Sie diese im Uhrzeigersinn, bis die Stange fest auf der Kolbendichtung sitzt (Widerstand fühlbar).

i Vermeiden Sie es, die Seiten oder das Gewinde der Kolbenstange zu berühren.

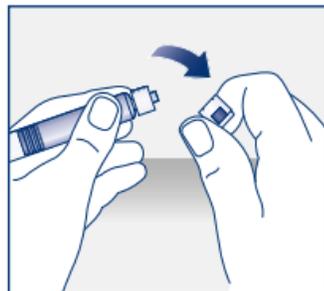

Entfernen Sie die Spritzenkappe, indem Sie die Kappe an der Perforierung abknicken, bis sie bricht.

i Berühren Sie nicht die unter der Spritzenkappe befindliche Spritzenspitze. Verwenden Sie die Spritze nicht, wenn die Kappe locker ist oder fehlt.

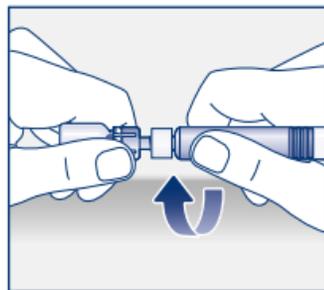

Schrauben Sie die vorgefüllte Spritze im Uhrzeigersinn vorsichtig auf den Adapter, bis diese fest sitzt (Widerstand fühlbar).

MISCHEN VON PULVER UND LÖSUNGSMITTEL



Halten Sie die Spritze schräg, die Durchstechflasche nach unten gerichtet, und drücken Sie die Kolbenstange vorsichtig herunter, um das Lösungsmittel vollständig in die Durchstechflasche zu injizieren.




Lassen Sie die Kolbenstange heruntergedrückt und schwenken Sie die Flasche leicht im Kreis (Flasche nicht schütteln), bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat.

i Verwerfen Sie die Lösung, wenn sie sichtbare Partikel enthält oder nicht klar und farblos ist.

i Es wird empfohlen, Esperoct® sofort nach der Rekonstitution anzuwenden, da es möglicherweise nicht länger steril ist. Wenn Sie rekonstituiertes Esperoct® nicht sofort anwenden können, sollte es bei Lagerung bei Raumtemperatur (max. 30 °C) innerhalb von 4 Stunden und bei Lagerung im Kühlschrank (2 °C–8 °C, nicht einfrieren) innerhalb von 24 Stunden angewendet werden. Die Wirkstärken 500 I.E., 1 000 I.E., 1 500 I.E., 2 000 I.E. und 3 000 I.E. können nach Rekonstitution außerdem 1 Stunde zwischen >30 °C und 40 °C aufbewahrt werden, aber nur, wenn Esperoct® vor der Rekonstitution für nicht länger als 3 Monate über Raumtemperatur (>30 °C bis zu 40 °C) aufbewahrt wurde. Lagern Sie das rekonstituierte Esperoct® vor Licht geschützt in der Durchstechflasche und nicht in der Spritze.

MISCHEN VON PULVER UND LÖSUNGSMITTEL (FORTSETZUNG)

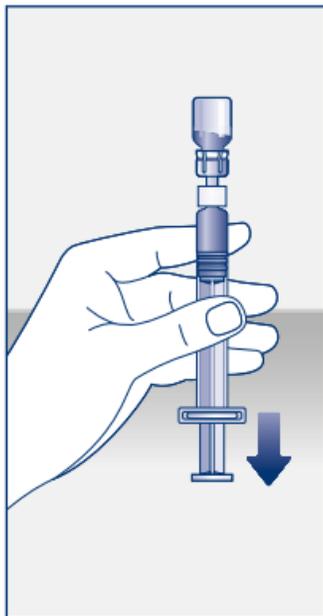


Drehen Sie nun die Spritze um. Lassen Sie die Kolbenstange los, damit die Lösung in die Spritze läuft.


Ziehen Sie die restliche Lösung mit der Kolbenstange in die Spritze auf.

Tippen Sie leicht an die Spritze, während Sie die Durchstechflasche auf den Kopf gedreht halten, um jegliche Luftblasen an die Oberfläche aufsteigen zu lassen.

i Berühren Sie nicht die Spritzenspitze, da diese sonst unsteril werden könnte.

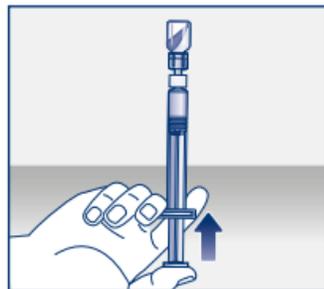

Drücken Sie die Kolbenstange langsam nach oben, so dass die Spritze keine Luft mehr enthält.

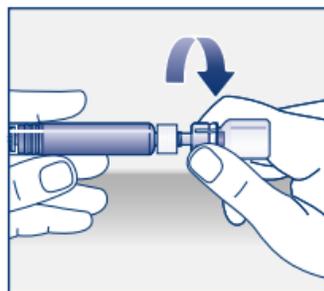

Schrauben Sie den Adapter mit der Durchstechflasche von der Spritze ab.

❗ Falls Sie nur einen Teil der Durchstechflasche benötigen, benutzen Sie die Skala auf der Spritze, um zu sehen, wieviel Lösung Sie aufziehen, damit das Volumen genau den Anweisungen Ihres Arztes oder des medizinischen Fachpersonals entspricht.

❗ Verabreichen Sie Esperoct® intravenös über eine Injektionsdauer von etwa 2 Minuten.

❗ Mischen Sie Esperoct® niemals mit anderen intravenösen Infusionen oder Medikamenten.

❗ Verbrauchen Sie den gesamten Spritzeninhalt auf einmal. Wenn Sie nicht die gesamte angemischte Menge verbrauchen, lesen Sie bezüglich der Haltbarkeit die Hinweise in der Packungsbeilage.



❗ Entsorgen Sie die Spritze, den Adapter, die Durchstechflaschen, das Injektionszubehör sowie etwaige Produktreste ordnungsgemäß wie von Ihrem Apotheker angewiesen. Entsorgen Sie diese Materialien nicht mit Ihrem normalen Haushaltsabfall.

❗ Nehmen Sie die gebrauchten Materialien nicht auseinander, bevor Sie sie entsorgen.

❗ Gebrauchte Materialien nicht wiederverwenden.

esperoct®
turoctocog alfa pegol

Unser Ziel ist es, dass Esperoct® und unsere Services Sie bei all Ihren Aktivitäten unterstützen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen dazu haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

 **06131-903 1133** (zum deutschen Festnetztarif)

 **KD_Service@novonordisk.com**



**Besuchen Sie auch unsere Website
für Menschen mit Hämophilie: haemcare.de**

Quelle: Esperoct® Gebrauchsinformation, Stand Oktober 2024.

Novo Nordisk Pharma GmbH, Mainz

Tel.: 06131 903 0, Fax: 06131 903 1370, novonordisk.de

Esperoct® ist eine eingetragene Marke der Novo Nordisk Health Care AG und der Apis-Stier ist eine eingetragene Marke von Novo Nordisk A/S. © 2025 Novo Nordisk Health Care AG, Zürich, Schweiz.

Art.-Nr. 713297 (06/2025) DE25ESP00018 Druck: 07/2025

